




ARNES PARA USO GENERAL

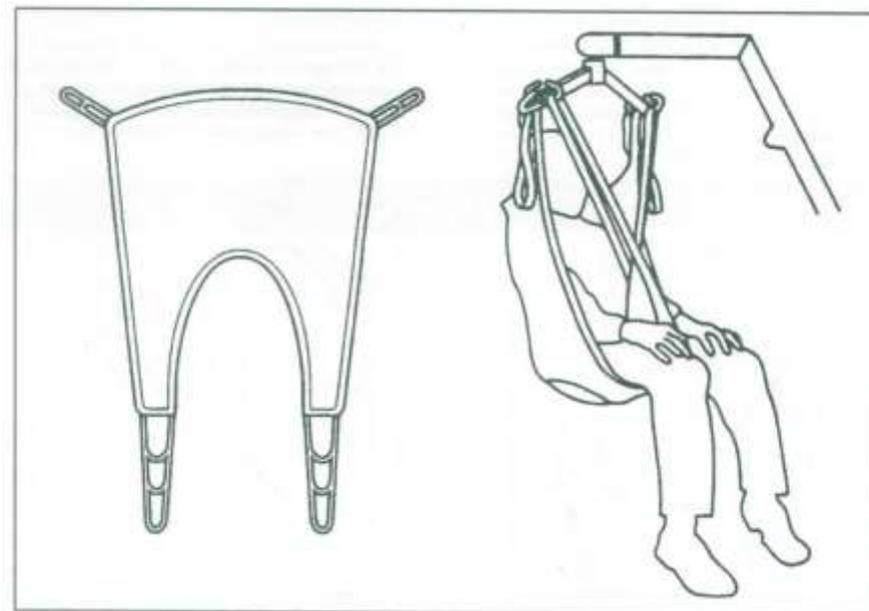

OTRA INFORMACION:

Fabricante: Target Medical S.A.
La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande,
Provincia de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:
Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899

Códigos K174 / K175 / K176

Garantía 1 año

Vida útil 2 años

93008 Emisión 2 04/2016

MANUAL DE USO

INTRODUCCION

Los arneses para uso general **Care-Quip Argentina** han sido diseñados para el traslado de aproximadamente un 85 % de pacientes con dificultades de movilidad. Aptos para el uso diario y una colocación sencilla.

Los mismos están fabricados en tela y correas reforzadas para un usuario individual de hasta 150 kg. Disponible en tres talles: Pequeño, Mediano y Grande.

El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto. El uso incorrecto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o a terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

ADVERTENCIAS

Leer detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el arnés.

Utilizar el arnés siempre según las indicaciones y tener presente los riesgos de lesiones hacia el usuario y hacia otras personas.

Respetar el peso máximo admitido y no sobrecargar el arnés.

Ubicar siempre las correas más largas en las piernas y las correas más cortas en los hombros.

Asegurar que la cabeza del paciente este sostenida en todo momento

Todos nuestros arneses son aptos para el uso con el levanta-paciente **Care-Quip Argentina**.

Para solucionar necesidades especiales consulte con su casa vendedora.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El talle de cada arnés se identifica por el color del ribete alrededor del arnés.

CODIGO	COLOR DEL RIBETE	TALLE	MEDIDA A (mm)	MEDIDA B (mm)	MEDIDA C (mm)
K174	Rojo	Pequeño	735	550	1010
K175	Amarillo	Mediano	850	620	1070
K176	Verde	Grande	1020	720	1180




MANTENIMIENTO

Limpiar el arnés con agua y jabón neutro.

No utilizar cepillos, esponjas abrasivas o limpiadores químicos.

De no utilizar el arnés por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.



Temperatura máxima de agua indicada es 71°C.



No utilizar cloro ni lavandina.



No planchar.



Secar a la sombra.




No secar en máquina ni centrifugar.

COLOCACION DEL ARNES

COMO COLOCAR EL ARNES CON EL PACIENTE SENTADO



Paso 1 - Deslizar el arnés por detrás de la espalda y asegurarse de que las correas cortas se encuentren a ambos costados del paciente, dejando la abertura sanitaria a la altura de la cintura. El arnés debe quedar nivelado con los hombros.

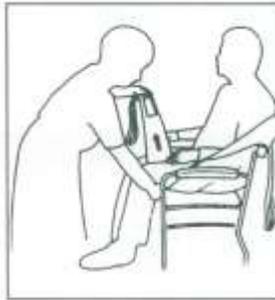

Paso 2 - Levantar la pierna del paciente, pasar la correa larga por debajo de la pierna y levantarla entre las piernas. Asegurarse que la tela del arnés no esté doblada o arrugada debajo del muslo. Repetir este procedimiento con la otra correa.




Paso 3 - Cruzar las correas largas y enganchar los puntos más extensos de las correas en los ganchos delanteros del levanta-pacientes.




Paso 4 - Enganchar los puntos más cortos de las correas de los hombros en los ganchos traseros del levanta-pacientes. Luego se puede comenzar a elevar el levanta-pacientes.

POSICIONES ALTERNATIVAS DE SENTADO




Para mayor comodidad del paciente, pasar cada correa larga por debajo de ambas piernas y engancharlas sin cruzar al levanta-pacientes. (como muestra la figura)




Para mayor inclinación del paciente, enganchar las correas de los hombros en el punto más extenso de la correa y/o enganchar las correas de las piernas en alguno de los puntos más cortos. (como muestra la figura)

COMO COLOCAR EL ARNES CON EL PACIENTE ACOSTADO

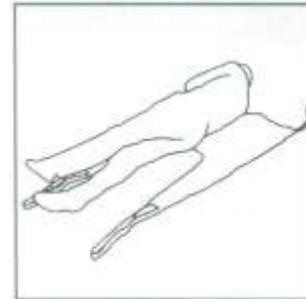

Ubicar al paciente sobre el arnés, asegurarse que la abertura sanitaria quede a la altura de la cintura.

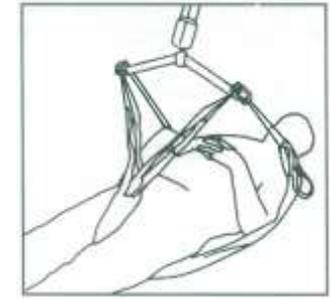

Pasar y cruzar las correas largas entre las piernas. Enganchar los puntos más extensos de las correas en los ganchos delanteros del levanta-pacientes. Enganchar los puntos más cortos de las correas de los hombros en los ganchos traseros del levanta-pacientes. Luego se puede comenzar a elevar el levanta-pacientes.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en este manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar este certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:

Fecha:

Firma: Aclaración: